

Johnson & Johnson  
MedTech

# Catálogo de Productos





Escaneá el QR y consultá el catálogo online o ingresá a [sensimat.com.ar/tablas](https://sensimat.com.ar/tablas)



cirugía  
plástica

## Índice

<b>IMPLANTES MAMARIOS MEMORYGEL™ / REDONDOS</b>	<b>4</b>
Perfil Moderado Plus Texturizado	
Perfil Alto Texturizado	
Perfil Moderado Plus Liso	
Perfil Alto Liso	
<b>IMPLANTES MAMARIOS MEMORYGEL™XTRA / REDONDOS</b>	<b>6</b>
Perfil Moderado Plus Texturizado Xtra	
Perfil Alto Texturizado Xtra	
Perfil Moderado Plus Liso Xtra	
Perfil Alto Liso Xtra	
<b>PERFILES IMPLANTES MAMARIOS SILTEX™ CPG™ / ANATÓMICOS</b>	<b>8</b>
322 Altura Media / Proyección Moderada Plus	
323 Altura Media / Proyección Alta	
332 Altura Alta / Proyección Moderada Plus	
333 Altura Alta / Proyección Alta	
<b>EXPANSORES DE TEJIDO MAMARIO CPX™4 / ANATÓMICOS</b>	<b>10</b>
Estilo 9100 / Altura Baja	
Estilo 9200 / Altura Media	
Estilo 9300 / Altura Completa	
<b>CENTERSCOPE™</b>	
<b>LOCALIZADOR DEL PUERTO DE INYECCIÓN</b>	<b>11</b>

# Implantes Mamarios MemoryGel™ / Redondos



## Implantes Mamarios MemoryGel™ / Redondos

PERFIL MODERADO PLUS TEXTURIZADO				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
125	8,8	2,9	354-1251	RSZ-1251
150	9,4	3,0	354-1501	RSZ-1501
175	10,0	3,2	354-1751	RSZ-1751
200	10,5	3,3	354-2001	RSZ-2001
225	10,9	3,5	354-2251	RSZ-2251
250	11,3	3,6	354-2501	RSZ-2501
275	11,7	3,7	354-2751	RSZ-2751
300	12,0	3,7	354-3001	RSZ-3001
325	12,3	3,8	354-3251	RSZ-3251
350	12,6	3,8	354-3501	RSZ-3501
375	12,9	3,9	354-3751	RSZ-3751
400	13,2	4,0	354-4001	RSZ-4001
450	13,7	4,1	354-4501	RSZ-4501
500	14,1	4,2	354-5001	RSZ-5001
550	14,4	4,4	354-5501	RSZ-5501
600	14,7	4,5	354-6001	RSZ-6001
700	15,7	4,8	354-7001	RSZ-7001
800	16,6	5,0	354-8001	RSZ-8001

PERFIL ALTO TEXTURIZADO				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
125	8,4	3,6	354-4125	RSZ-1254
150	8,9	3,8	354-4150	RSZ-1504
175	9,4	4,0	354-4175	RSZ-1754
200	9,9	4,1	354-4200	RSZ-2004
225	10,2	4,3	354-4225	RSZ-2254
250	10,5	4,5	354-4250	RSZ-2504
275	10,9	4,6	354-4275	RSZ-2754
300	11,1	4,7	354-4300	RSZ-3004
325	11,5	4,8	354-4325	RSZ-3254
350	11,7	4,9	354-4350	RSZ-3504
375	12,0	5,0	354-4375	RSZ-3754
400	12,3	5,1	354-4400	RSZ-4004
425	12,5	5,2	354-4425	RSZ-4254
450	12,7	5,2	354-4450	RSZ-4504
500	13,2	5,4	354-4500	RSZ-5004
550	13,5	5,6	354-4550	RSZ-5504
600	14,0	5,7	354-4600	RSZ-6004
650	14,3	5,8	354-4650	RSZ-6504
700	14,7	6,0	354-4700	RSZ-7004
800	15,4	6,3	354-4800	RSZ-8004

PERFIL MODERADO PLUS LISO				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
125	8,9	2,8	350-1251 BC	RSZ-1251
150	9,5	2,9	350-1501 BC	RSZ-1501
175	10,0	3,1	350-1751 BC	RSZ-1751
200	10,5	3,2	350-2001 BC	RSZ-2001
225	10,9	3,3	350-2251 BC	RSZ-2251
250	11,3	3,4	350-2501 BC	RSZ-2501
275	11,7	3,5	350-2751 BC	RSZ-2751
300	12,0	3,6	350-3001 BC	RSZ-3001
325	12,3	3,8	350-3251 BC	RSZ-3251
350	12,5	3,9	350-3501 BC	RSZ-3501
375	12,8	4,0	350-2751 BC	RSZ-3751
400	13,1	4,0	350-4001 BC	RSZ-4001
450	13,6	4,2	350-4501 BC	RSZ-4501
500	14,1	4,3	350-5001 BC	RSZ-5001
550	14,6	4,5	350-5501 BC	RSZ-5501
600	15,0	4,6	350-6001 BC	RSZ-6001
700	15,8	4,9	350-7001 BC	RSZ-7001
800	16,5	5,1	350-8001 BC	RSZ-8001

PERFIL ALTO LISO				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
125	8,4	3,5	350-1254 BC	RSZ-1254
150	8,9	3,7	350-1504 BC	RSZ-1504
175	9,4	3,9	350-1754 BC	RSZ-1754
200	9,9	4,0	350-2004 BC	RSZ-2004
225	10,2	4,2	350-2254 BC	RSZ-2254
250	10,5	4,3	350-2504 BC	RSZ-2504
275	10,9	4,4	350-2754 BC	RSZ-2754
300	11,1	4,5	350-3004 BC	RSZ-3254
325	11,5	4,6	350-3254 BC	RSZ-3254
350	11,7	4,8	350-3504 BC	RSZ-3504
375	12,0	4,8	350-3754 BC	RSZ-3754
400	12,3	5,0	350-4004 BC	RSZ-4004
425	12,5	5,0	350-4254 BC	RSZ-4254
450	12,7	5,1	350-4504 BC	RSZ-4504
500	13,2	5,3	350-5004 BC	RSZ-5004
550	13,5	5,5	350-5504 BC	RSZ-5504
600	14,0	5,6	350-6004 BC	RSZ-6004
650	14,3	5,7	350-6504 BC	RSZ-6504
700	14,7	5,8	350-7004 BC	RSZ-7004
800	15,4	6,0	350-8004 BC	RSZ-8004

# Implantes Mamarios MemoryGel™Xtra / Redondos



## Implantes Mamarios MemoryGel™Xtra / Redondos

PERFIL MODERADO PLUS TEXTURIZADO XTRA				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
130	8,9	3,1	TMPX-130	RSZ-MPX-130
160	9,5	3,3	TMPX-160	RSZ-MPX-160
190	10,0	3,4	TMPX-190	RSZ-MPX-190
215	10,4	3,6	TMPX-215	RSZ-MPX-215
240	10,8	3,7	TMPX-240	RSZ-MPX-240
270	11,4	3,8	TMPX-270	RSZ-MPX-270
295	11,5	4,0	TMPX-295	RSZ-MPX-295
325	11,9	4,1	TMPX-325	RSZ-MPX-325
350	12,3	4,1	TMPX-350	RSZ-MPX-350
370	12,6	4,1	TMPX-370	RSZ-MPX-370
405	12,7	4,4	TMPX-405	RSZ-MPX-405
440	13,1	4,5	TMPX-440	RSZ-MPX-440
490	13,6	4,7	TMPX-490	RSZ-MPX-490
545	14,0	4,9	TMPX-545	RSZ-MPX-545
605	14,5	5,1	TMPX-605	RSZ-MPX-605
645	14,9	5,1	TMPX-645	RSZ-MPX-645
755	15,7	5,4	TMPX-755	RSZ-MPX-755

PERFIL ALTO TEXTURIZADO XTRA				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
150	8,3	4,1	THPX-150	RSZ-THPX-150
180	8,8	4,4	THPX-175	RSZ-THPX-175
200	9,2	4,5	THPX-200	RSZ-THPX-200
235	9,5	4,9	THPX-230	RSZ-THPX-230
260	9,9	5,0	THPX-255	RSZ-THPX-255
285	10,3	5,0	THPX-285	RSZ-THPX-285
335	10,7	5,4	THPX-325	RSZ-THPX-325
355	11,0	5,5	THPX-340	RSZ-THPX-340
380	11,3	5,5	THPX-365	RSZ-THPX-365
415	11,5	5,8	THPX-405	RSZ-THPX-405
450	11,9	5,9	THPX-425	RSZ-THPX-425
465	12,1	5,8	THPX-455	RSZ-THPX-455
490	12,5	5,8	THPX-470	RSZ-THPX-470
535	12,7	6,0	THPX-515	RSZ-THPX-515
595	13,1	6,3	THPX-570	RSZ-THPX-570
650	13,5	6,5	THPX-620	RSZ-THPX-620
700	14,1	6,5	THPX-680	RSZ-THPX-680
765	14,4	6,7	THPX-725	RSZ-THPX-725
790	14,8	6,7	THPX-765	RSZ-THPX-765

PERFIL MODERADO PLUS LISO XTRA				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
130	9,1	3,1	SMPX-130	RSZ-MPX-130
160	9,5	3,3	SMPX-160	RSZ-MPX-160
190	10,1	3,5	SMPX-190	RSZ-MPX-190
215	10,5	3,6	SMPX-215	RSZ-MPX-215
240	10,9	3,8	SMPX-240	RSZ-MPX-240
270	11,4	3,9	SMPX-270	RSZ-MPX-270
295	11,6	4,1	SMPX-295	RSZ-MPX-295
325	11,9	4,2	SMPX-325	RSZ-MPX-325
350	12,2	4,3	SMPX-350	RSZ-MPX-350
370	12,7	4,3	SMPX-370	RSZ-MPX-370
405	12,8	4,5	SMPX-405	RSZ-MPX-405
440	13,1	4,8	SMPX-440	RSZ-MPX-440
490	13,6	4,8	SMPX-490	RSZ-MPX-490
545	14,1	5,0	SMPX-545	RSZ-MPX-545
605	14,4	5,3	SMPX-605	RSZ-MPX-605
645	15,0	5,3	SMPX-645	RSZ-MPX-645
755	15,7	5,6	SMPX-755	RSZ-MPX-755

PERFIL ALTO LISO XTRA				
Volumen (cc)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
150	8,4	4,2	SHPX-150	RSZ-SHPX-150
175	9,0	4,4	SHPX-180	RSZ-SHPX-180
200	9,4	4,5	SHPX-200	RSZ-SHPX-200
230	9,8	4,8	SHPX-235	RSZ-SHPX-235
255	10,1	4,9	SHPX-260	RSZ-SHPX-260
285	10,5	5,1	SHPX-285	RSZ-SHPX-285
325	10,8	5,4	SHPX-335	RSZ-SHPX-335
340	11,1	5,4	SHPX-355	RSZ-SHPX-355
365	11,4	5,5	SHPX-380	RSZ-SHPX-380
405	11,6	5,9	SHPX-415	RSZ-SHPX-415
425	11,9	5,8	SHPX-450	RSZ-SHPX-450
455	12,1	6,0	SHPX-465	RSZ-SHPX-465
470	12,3	5,9	SHPX-490	RSZ-SHPX-490
515	12,6	6,2	SHPX-535	RSZ-SHPX-535
570	13,2	6,3	SHPX-595	RSZ-SHPX-595
620	13,4	6,5	SHPX-650	RSZ-SHPX-650
680	14,0	6,6	SHPX-700	RSZ-SHPX-700
725	14,5	6,7	SHPX-755	RSZ-SHPX-755
765	14,7	6,7	SHPX-790	RSZ-SHPX-790

# Perfiles Implantes Mamarios SILTEX™ CPG™ / Anatómicos



# Perfiles Implantes Mamarios SILTEX™ CPG™ / Anatómicos




322 ALTURA MEDIA / PROYECCIÓN MODERADA PLUS						
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco Polo Inf. A-B (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
140	9.0	8.5	3.8	7.6	334-0905	RSZ-0905
165	9.5	8.9	4.0	8.0	334-0955	RSZ-0955
195	10.0	9.4	4.2	8.4	334-1005	RSZ-1005
225	10.5	9.9	4.4	8.8	334-1055	RSZ-1055
255	11.0	10.3	4.7	9.2	334-1105	RSZ-1105
295	11.5	10.8	4.9	9.5	334-1155	RSZ-1155
330	12.0	11.3	5.1	9.9	334-1205	RSZ-1205
375	12.5	11.8	5.3	10.3	334-1255	RSZ-1255
420	13.0	12.2	5.5	10.7	334-1305	RSZ-1305
475	13.5	12.7	5.7	11.1	334-1355	RSZ-1355
525	14.0	13.2	5.9	11.4	334-1405	RSZ-1405
585	14.5	13.6	6.1	11.8	334-1455	RSZ-1455
650	15.0	14.1	6.3	12.2	334-1505	RSZ-1505

323 ALTURA MEDIA / PROYECCIÓN ALTA						
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco Polo Inf. A-B (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
165	9.0	8.5	4.6	8.1	334-0902	RSZ-0902
195	9.5	8.9	4.8	8.5	334-0952	RSZ-0952
225	10.0	9.4	5.1	8.9	334-1002	RSZ-1002
260	10.5	9.9	5.3	9.3	334-1052	RSZ-1052
300	11.0	10.3	5.6	9.7	334-1102	RSZ-1102
345	11.5	10.8	5.8	10.1	334-1152	RSZ-1152
390	12.0	11.3	6.0	10.5	334-1202	RSZ-1202
440	12.5	11.8	6.2	10.9	334-1252	RSZ-1252
495	13.0	12.2	6.5	11.3	334-1302	RSZ-1302
555	13.5	12.7	6.7	11.8	334-1352	RSZ-1352
620	14.0	13.2	6.9	12.2	334-1402	RSZ-1402
685	14.5	13.6	7.1	12.6	334-1452	RSZ-1452

LEYENDA DE LA DESIGNACIÓN CPG™		
Nivel de Cohesión	Altura del Implante	Proyección del Implante
III 3	ALTA 3	HIGH 3
III 3	MEDIA 2	MODERADA PLUS 2
III 3	BAJA 1	MODERADA 1
CLAVE	DÍGITO 1 = NIVEL DE COHESIÓN DÍGITO 2 = ALTURA DEL IMPLANTE DÍGITO 3 = PROYECCIÓN DEL IMPLANTE	

## COMPRESIÓN DE LAS MEDIDAS "A" Y LONGITUD DE ARCO

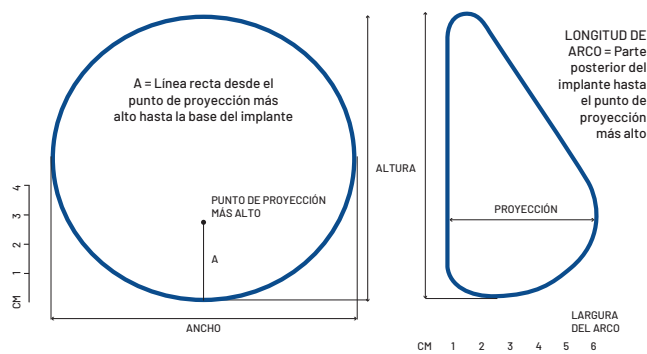

Diseño sin escala, solamente para referencia



332 ALTURA ALTA / PROYECCIÓN MODERADA PLUS						
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco Polo Inf. A-B (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
145	9.0	9.4	3.8	8.1	334-0909	RSZ-0909
175	9.5	9.9	4.0	8.5	334-0959	RSZ-0959
205	10.0	10.4	4.2	8.9	334-1009	RSZ-1009
235	10.5	10.9	4.4	9.3	334-1059	RSZ-1059
270	11.0	11.5	4.7	9.7	334-1109	RSZ-1109
305	11.5	12.0	4.9	10.1	334-1159	RSZ-1159
350	12.0	12.5	5.1	10.5	334-1209	RSZ-1209
395	12.5	13.0	5.3	10.9	334-1259	RSZ-1259
445	13.0	13.5	5.5	11.3	334-1309	RSZ-1309
495	13.5	14.1	5.7	11.7	334-1359	RSZ-1359
555	14.0	14.6	5.9	12.1	334-1409	RSZ-1409
615	14.5	15.1	6.1	12.6	334-1459	RSZ-1459
680	15.0	15.6	6.3	13.0	334-1509	RSZ-1509

333 ALTURA ALTA / PROYECCIÓN ALTA						
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Arco Polo Inf. A-B (cm)	Nº Catálogo	Medidor de gel reesterilizable
180	9.0	9.4	4.6	8.4	334-0904	RSZ-4090
215	9.5	9.9	4.8	8.8	334-0954	RSZ-4095
250	10.0	10.4	5.1	9.3	334-1004	RSZ-4100
290	10.5	10.9	5.3	9.7	334-1054	RSZ-4105
330	11.0	11.5	5.6	10.1	334-1104	RSZ-4110
380	11.5	12.0	5.8	10.5	334-1154	RSZ-4115
430	12.0	12.5	6.0	11.0	334-1204	RSZ-4120
485	12.5	13.0	6.2	11.4	334-1254	RSZ-4125
545	13.0	13.5	6.5	11.8	334-1304	RSZ-4130
610	13.5	14.1	6.7	12.2	334-1354	RSZ-4135
680	14.0	14.6	6.9	12.7	334-1404	RSZ-4140
755	14.5	15.1	7.1	13.1	334-1454	RSZ-4145

# Expansores de Tejido Mamario CPX™4 / Anatómicos



## Expansores de Tejido Mamario CPX™4 / Anatómicos

ESTILO 9100 / ALTURA BAJA				
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo
250	11,4	8,1	6,1	3549111
350	12,7	9,4	6,5	3549112
450	14,0	10,2	7,1	3549113
550	15,0	10,9	7,4	3549114
650	15,7	11,2	7,9	3549115
750	16,5	11,9	8,1	3549116


ESTILO 9200 / ALTURA MEDIA				
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo
275	10,7	9,3	6,2	3549211
350	11,7	10,0	6,6	3549212
450	12,7	10,8	7,0	3549213
550	13,5	11,7	7,4	3549214
650	14,6	12,6	7,6	3549215
800	15,6	13,3	8,0	3549216

ESTILO 9300 / ALTURA COMPLETA				
Volumen (cc)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)	Nº Catálogo
250	10,1	10,7	5,6	3549311
350	11,3	11,8	6,0	3549312
450	12,3	12,9	6,5	3549313
550	13,2	13,8	6,9	3549314
650	14,0	14,6	7,3	3549315
750	14,6	15,3	7,6	3549316
850	15,4	15,9	7,0	3549315


3 lengüetas de sutura en posición 3, 6 y 9 de las agujas del reloj



## CENTERSCOPE™ Localizador del puerto de inyección

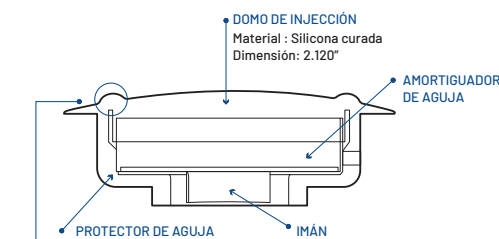

Esto representa el anillo de palpación; este anillo no está presente en el dispositivo CPX™ 4

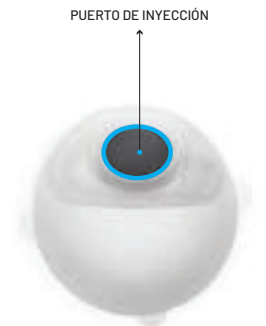

## SEDE DE LA CORPORACIÓN

Santa Bárbara, CA 93111 USA

www.mentormdatam.com

## INFORMACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES DE MENTOR®

Colombia – Gilmédica AS – 57 2 6903999

Costa Rica – Diopsa AS – 506 22568034

Argentina – Buenos Aires: ICOM – (11) 4667 8595

Argentina – Provincias excepto Buenos Aires: SENSIMAT – (0341) 4824122

Chile – MedCorp – 562 951 6936

Perú – Implants S.A.C. – 511 2420896

Uruguay – ProMediK – 5 98 2 6 28 3 818

Bolivia – GEDESA – 5 91 4 –2421601

Puerto Rico – Vitalife

Trinidad & Tobago – AA laquis

México

- Baja California y Sonora: Insumos Médicos de Mexicali +52 664 442 5302
- Jalisco, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Baja California Sur y Sinaloa: Medical Stock. +52 33 1800 3985
- Ciudad de México y zona Metropolitana, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Puebla y Morelos: Pego Medical. +52 55 5555 3924 / +52 55 5683 9220 / +52 55 5555 3925
- Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo: TMS medical supplies. +52 833 311 2416

### Argentina:

PM-16-403 / PM-16-751 / PM-16-772 / PM-16-402 / PM-16-637 / PM-16-401 / PM-16-321

### Colombia:

INVIMA 2010 DM – 0006719 / INVIMA 2011 DM – 0007151

INVIMA 2011 DM – 0007664 / INVIMA 2020 DM – 0005894 – R1

INVIMA 2017 DM – 0001401 – R1

### Perú:

DM12811E / DM16905E / DM12791E

### México:

1923C2002 SSA / 0880C2015 SSA

1922C2002 SSA / 0842C2013 SSA

Num. Aut. 213300202C8366

mentorimplantes.com

mentorla@its.jnj.com



En Argentina: Johnson & Johnson Medical S.A. Mendoza 1259. Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina. CP: C1428DJG En Chile: Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado 5240, torre1, piso 9, Las Condes, Santiago de Chile. En Colombia: Johnson & Johnson de Colombia S.A. Yumbo-Valle: Calle 15 No. 31-146 ACOPI. En Costa Rica: Johnson & Johnson de Costa Rica, S.A. Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 5. San Rafael de Escazú, San José, Costa Rica. En Mexico: Johnson & Johnson de Mexico, S.A. Blvd. Adolfo Ruiz Cortines #3720, Torre 1 – Piso 3, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Del Álvaro Obregón, CDMX. En Panama: Ethnor del Istmo, S.A. Complejo Business Park, entre Ave La Rotonda y Ave Principal, Edificio Sur, Piso 1, Costa del Este. Republic of Panama – Panama. PO Box 0835-00241. En Peru: Johnson & Johnson del Peru S.A. Av. Canaval y Moreyra, No. 480, Piso 9-13. San Isidro. Lima 27, Peru. Contacto: RA-MDDCInfoReqMAF@ITS.JNJ.com En Uruguay: Johnson & Johnson de Uruguay S.A. Edificio Art Carrasco Business. Av. Italia 7519 – Oficina 301. CP 11500 Montevideo-Uruguay. En Puerto Rico: Johnson & Johnson Medical Caribbean an unincorporated division of Johnson & Johnson International. 475 Calle C, Suite 200, Guaynabo, PR 00969.

Antes de la intervención, es la responsabilidad del cirujano advertir a futuros pacientes o sus representantes acerca de posibles complicaciones asociadas con el uso de este producto. Comprobar la disponibilidad, en su localidad, de los productos presentados.